

铁离子还原能力(ferric reducing ability of plasma)试剂盒说明书

(货号: BP10052W 微板法 96样 有效期: 3个月)

一、指标介绍:

抗氧化物可以还原 Fe^{3+} -三吡啶三吖嗪(Fe^{3+} -TPTZ)产生蓝色的 Fe^{2+} -TPTZ,随后在 590nm 测定蓝色的 Fe^{2+} -TPTZ 即可获得样品中的铁离子还原能力,吸光值越高表示样品的还原能力越强。

二、试剂盒组分与配制:

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项
试剂一	液体 15mL×1 瓶	4℃避光保存	
试剂二	液体 1.5mL×1 支	4℃避光保存	
试剂三	液体 1.5mL×1 支	4℃避光保存	
标准品	粉体 1 支	4℃保存	1. 若重新做标曲,则用到该试剂;
			2. 按照说明书中标曲制作步骤进行
			配制;
			3. 溶解后的标品一周内用完。

三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 96 孔板、离心管、酶标仪、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

四、指标测定:

建议先选取 1-3 个差异大的样本(例如不同类型或分组)进行预实验,熟悉操作流程,根据预实验结果确定或调整样本浓度,以防造成样本或试剂不必要的浪费!

1、样本提取:

① 组织样本:

称取 0.1g 样本(若是干样可取 0.02-0.05g),加入 1mL 的 80%乙醇(自备)进行匀浆,匀浆后转入 2mL 离心管中; 于 60%, 200-300W 条件下超声提取 30min(间隔 5min 振荡混匀一次)。12000rpm, 离心 10min,取上清,置冰上待测。

- ② 液体样本: 水溶性样本可直接检测。若是油性样本, 可用 80%乙醇溶解后再取上清检测。
- ③ 细菌/培养细胞:

先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;取 500 万细菌或细胞加入 1mL 的 80%乙醇提取液,超声波破碎细菌或细胞(冰浴,功率 200W,超声 3s,间隔 10s,重复 30 次),12000rpm,离心 10min,取上清置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量 (10⁴个): 提取液 (mL) 为 1000~5000: 1 比例进行提取。

2、检测步骤:

- ① 酶标仪预热 30min(等待仪器过自检程序亦可),调节波长至 590nm。
- ② 显色液配置:将试剂一、试剂二、试剂三按 10:1:1 的比例混合,使用前 37℃预温,现配现用,注意避光。
- ③ 不同样本抗氧化能力不一,**可先选取**2个样本做检测,若A测定超过1.5,需对样本用80%乙醇 稀释,稀释倍数D代入公式计算。
- ④ 在96 孔板中依次加入:

试剂组分(μL)	测定管	空白管 (只做一次)
样本	5	0
蒸馏水	25	30

网址: www.bpelisa.com




显色液		170	170	
混匀后, 室温 25℃, 准确反应 10min, 于 590nm 处读取吸)min,于 590nm 处读取吸	
光值 A; △A=A 测定-A 空白;				

【注】1. 若 A 测定值超过 1.5,可对样本用提取液进行稀释,或减少样本上样量 V1(如减至 $2\mu L$,则提取液增至 $28\mu L$),则稀释倍数 D 或加样量 V1 需代入公式重新计算。

2. 若 $\triangle A$ 的值在零附近,可增加样本量 V1(如增至 $15\mu L$,则蒸馏水相应减少),则改变后的 V1 需代入公式重新计算。

五、结果计算:

1、标准曲线: y = 0.321x-0.0164, x 是标准品(FeSO₄)摩尔浓度(μ mol/mL), y 是 \triangle A。

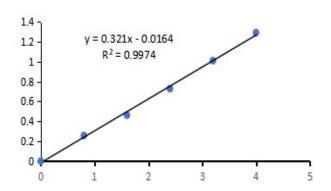

2、组织样本:

(1) 按样本质量计算:

铁离子还原能力(μmol FeSO₄/g 鲜重)=[(△A+0.0164)÷0.321×V1]÷(V1÷V×W)×D =3.11×(△A+0.0164)÷W×D

(2) 按样本蛋白浓度计算:

铁离子还原能力(μmol FeSO₄/mg prot)=[(△A+0.0164)÷0.321×V1]÷(V1×Cpr) ×D =3.11×(△A+0.0164)÷Cpr ×D

3、液体样本:

铁离子还原能力(μmol FeSO₄/mL)=[(△A+0.0164)÷0.321×V1]÷V1×D =3.11×(△A+0.0164)×D

4、细菌/细胞样本

铁离子还原能力(μmol FeSO₄/10⁴ cell) =[(△A+0.0164)÷0.321×V1]÷(V1÷V×500×D =0.0062×(△A+0.0164)×D

V---加入提取液体积, 1 mL; V1---反应中样品体积, 5μL=0.005 mL;

W---样品质量, g; D---稀释倍数, 未稀释即为 1;

500---细菌或细胞总数,万

Cpr---样本蛋白浓度,mg/mL,建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

【注意】:

- 1. 由于本方法是显蓝色测定吸光值,因此尽量避免使用在酸性条件下呈蓝色或接近蓝色的试剂,否则对本试剂盒的检测结果产生干扰。
- 2. 样本中不宜添加 Tween、Triton 和 NP-40 等去垢剂和 DTT、巯基乙醇等影响氧化还原反应的还原剂。
- 3. 如果样品测定出来的吸光值在标准曲线范围以外,需把样品适当稀释或浓缩后再进行测定。
- 4. 如果样本中处理过程中施加了较高浓度的铁盐或亚铁盐,会干扰测定,不宜使用本测试方法

网址: www.bpelisa.com



附:标准曲线制作过程:

- 1 标曲为非必做实验,用户可根据实验需求制作标曲,亦可直接采用说明书计算公式进行结果计算。
- 2 制备标准品母液(100μmol/mL):临用前加 1mL 蒸馏水,充分溶解混匀;
- 3 将母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品,例如:0, 0.8, 1.6, 2.4, 3.2, 4 μmol/mL。也可根据实际样本调整标准品浓度。
- 4 标品稀释参照表如下:

吸取标准品母液 50uL,加入 1.2ml 蒸馏水,混匀得到 4 μmol/mL 的标品稀释液待用。						
标品浓度µmol/mL	0	0.8	1.6	2.4	3.2	4
标品稀释液 uL	0	40	80	120	160	200
蒸馏水 uL	200	160	120	80	40	0
各标准管混匀待用。						

5 依据测定管的加样表操作,根据结果,以各浓度吸光值减去 0 浓度吸光值,过 0 点制作标准曲线。

试剂组分 (μL)	标准管	0 浓度管(仅做一次)
标品	5	
蒸馏水	25	30
显色液	170	170

混匀后, 室温 25℃, 准确反应 10min, 于 590nm 处读取吸光值 A; △A=A 标准-A0 浓度;

网址: www.bpelisa.com