

水中铵根离子含量试剂盒说明书

(货号: BP10371W 微板法 96样 有效期: 6个月)

一、指标介绍:

铵根离子含量是评价水质是否受到污染的一个重要指标,铵根离子在水中存在时呈游离氨或铵盐的 状态,两者组成主要取决于水的 PH 值。

本试剂盒采用靛酚蓝比色法,即在高 PH 值环境下,将水中的铵根离子转化成铵盐的存在形式来进行测定。水中铵根离子在强碱性介质中与苯酚和次氯酸钠作用,生成稳定的水溶性染料靛酚蓝,吸光度与铵根离子含量成正比,其在 625nm 处有特征吸收峰。

二、试剂盒组分与配制:

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项
试剂一	液体 12mL×1 瓶	4℃避光保存	
试剂二	A: 液体 10mL×1 瓶 B: 液体 0.2mL×1 支	4℃避光保存	 用前向 A 液中加入 100 μ L 的 B 液, 混匀后作为试剂二使用; 仍旧 4°C保存。
试剂三	液体 2.2mL×1 瓶	4℃保存	
标准品	液体 1mL×1 支	4℃保存	 若重新做标曲,则用到该试剂; 按照说明书中标曲制作步骤进行配制; 溶解后的标品一周内用完。

三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 96 孔板、离心管、酶标仪、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

四、指标测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂浪费!

1、样本提取:

水溶液或液体样本,直接进行检测。若溶液浑浊,12000rpm 常温离心 10min,取上清液。

2、检测步骤:

- ① 酶标仪预热 30min, 设置温度在 25℃, 设定波长为 625nm。
- ② 所有试剂在使用前均须在室温或 25℃水浴锅中温育 10min。
- ③ 在96孔板中按照下表依次加入试剂:

试剂 (μL)	测定管	空白管		
样本	20			
蒸馏水		20		
试剂一	100	100		
试剂二	100	100		
充分混匀, 25℃静置 1h				
试剂三	20	20		

充分混匀,于 625nm 处测定吸光值,分别记为 A 测定管和 A 空白管, \triangle A=A 测定管-A 空白管。

网址: www.bpelisa.com




【注】: 1、若 A 测定值大于 1.5, 可对样本用蒸馏水稀释,则稀释倍数 D 带入公式计算。

2、若 $\triangle A$ 小于 0.01,可增加样本加样体积 V1(如由 $20\mu L$ 增至 $60\mu L$ 或更多,则试剂一和试剂二分别减少 $20\mu L$,保持总体积不变)。则改变后的 V1 带入公式计算。

五、结果计算:

1、标准曲线: y = 4.8337x-0.0161; x 是标准品质量 (μg), y 是 ΔA 。

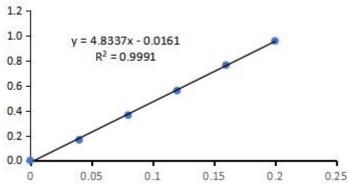

- 2、水中 NH_4 +含量($\mu g/mL$)=[($\triangle A+0.0161$)÷4.8337]÷ $V1\times D$ =0.207×($\triangle A+0.0161$)÷ $V1\times D$
- 3、水中 NH_4^+ -N 含量(μ g/mL)=[(\triangle A+0.0161)÷ 4.8337]÷V1÷18×14×D =0.161×(\triangle A+0.0161)÷V1×D

V1---样本加样体积, 20μL=0.02mL;

D---稀释倍数,未稀释即为 1。

附:标准曲线制作过程:

- 1 标准品母液浓度为 1mg/mL。将母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品,例如: 0, 2,4,6, 8,10 $\mu g/mL$ 。也可根据实际样本调整标准品浓度。
- 2 标品稀释参照表如下:

1. 贝	1. 吸取标准品母液 100uL,加入 900uL 蒸馏水,混匀得到 100ug/mL 的标品稀释液;					
2. 吸取 100u	2. 吸取 100ug/mL 的标品稀释液 100uL,加入 900uL 蒸馏水,混匀得到 10ug/mL 的标品稀释液待用。					
标品浓度	0	2	4	6	8	10
μg/mL	O	2	_ -	0	6	10
标品稀释液	0	40	80	120	160	200
uL	U	40	80	120	100	200
水 uL	200	160	120	80	40	0
各标准管混匀待用。						

3 依据测定管加样表操作,根据结果,以各浓度吸光值减去0浓度吸光值,过0点制作标准曲线。

试剂名称(μL)	标准管	0 浓度管(仅做一次)
标品	20	
蒸馏水		20
试剂一	100	100

网址: www.bpelisa.com



试剂二	100	100		
充分混匀,25℃静置 1h				
试剂三	20	20		
充分混匀,于 625nm 处测定吸光值,△A=A 测定-0 浓度管。				

网址: www.bpelisa.com